

計測・分析センター機器予約フォームのご利用方法

- ・ご利用は利用者登録申請書を提出後になります。初めてご利用される方は、計測・分析センターまでご連絡ください。
- ・未許可の方の予約は職員が削除いたします。
- ・予約フォームをご使用いただく際は、PC からアクセスして頂くようお願い致します。スマートフォン、タブレット等でも入力いただくことは可能ですがPC 推奨となります。

- ① 予約フォーム（ <https://kib.kqds.jp> ）を開く。
- ② 計測・分析センター機器予約フォーム（図 1）が表示されるので、予約したい装置の予約ボタン（図 1 の A から選択）をクリックする。

機器名	予約ボタン
透過型電子顕微鏡 (cryo-TEM)	予約
電界放出形走査電子顕微鏡・JEOL (FE-SEM)	予約
共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡 (CLSM)	予約
全自動水平型多目的X線回折装置 (XRD)	予約
蛍光X線分析装置 (XRF)	予約
X線光電子分光分析装置 (XPS)	予約
元素分析装置 (EA)	予約
安定同位体比質量分析計 (EA-IRMS)	予約
核磁気共鳴装置 (固体NMR)	予約
核磁気共鳴装置 (NMR)	予約
分光光度計 (UV)	予約
ラマン顕微鏡	予約
マルチタイフID分光分析装置 (ICP-AES)	予約

図 1. 計測・分析センター機器予約フォーム最初のページ

③ week のカレンダー（図 2）が表示されるので、カレンダーの左側にある矢印ボタン（図 2 の A）で予約したい週へ移動する。

※ 予約を行うときは、week 画面での予約を推奨します。

※ month 画面でも予約はできますが、他の予約が見えにくいのでお控えください。予約が重なったり、間違いやすくなったりします。

※ 図 2 の B と C のボタンは下記のとおりです。

・図 2 の B：カレンダーの切り替えボタン

・図 2 の C：today のボタン

今日に戻る

month：月のカレンダーを表示

week：週のカレンダーを表示

day：1 日のカレンダーを表示

北九州市立大学 計測・分析センター

機器一覧へ 管理者ログイン

全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）予約状況

< > today 2024年5月12日 - 18日 month week day

	5/12(日)	5/13(月)	5/14(火)	5/15(水)	5/16(木)	5/17(金)	5/18(土)
all-day							
9時							
10時							
11時							
12時							
13時							
14時							
15時							
16時							
17時							
18時							

図 2. 計測・分析センター機器予約フォーム（week のページ）

- ④ 予約したい日の予約開始の時間のところにカーソルを移動し、マウスの左ボタンを押したままマウスを動かし予約終了時間で手を離す。

例) 5月15日の11時から16時まで予約を入れる

図3のAの枠(11:00-11:30)の中でマウスの左ボタンを押し、押したまま図3のBの枠(15:30-16:00)の中まで移動させ手を離すと青色のバーができ、予約情報入力画面(手順⑤の図4)が表示される。

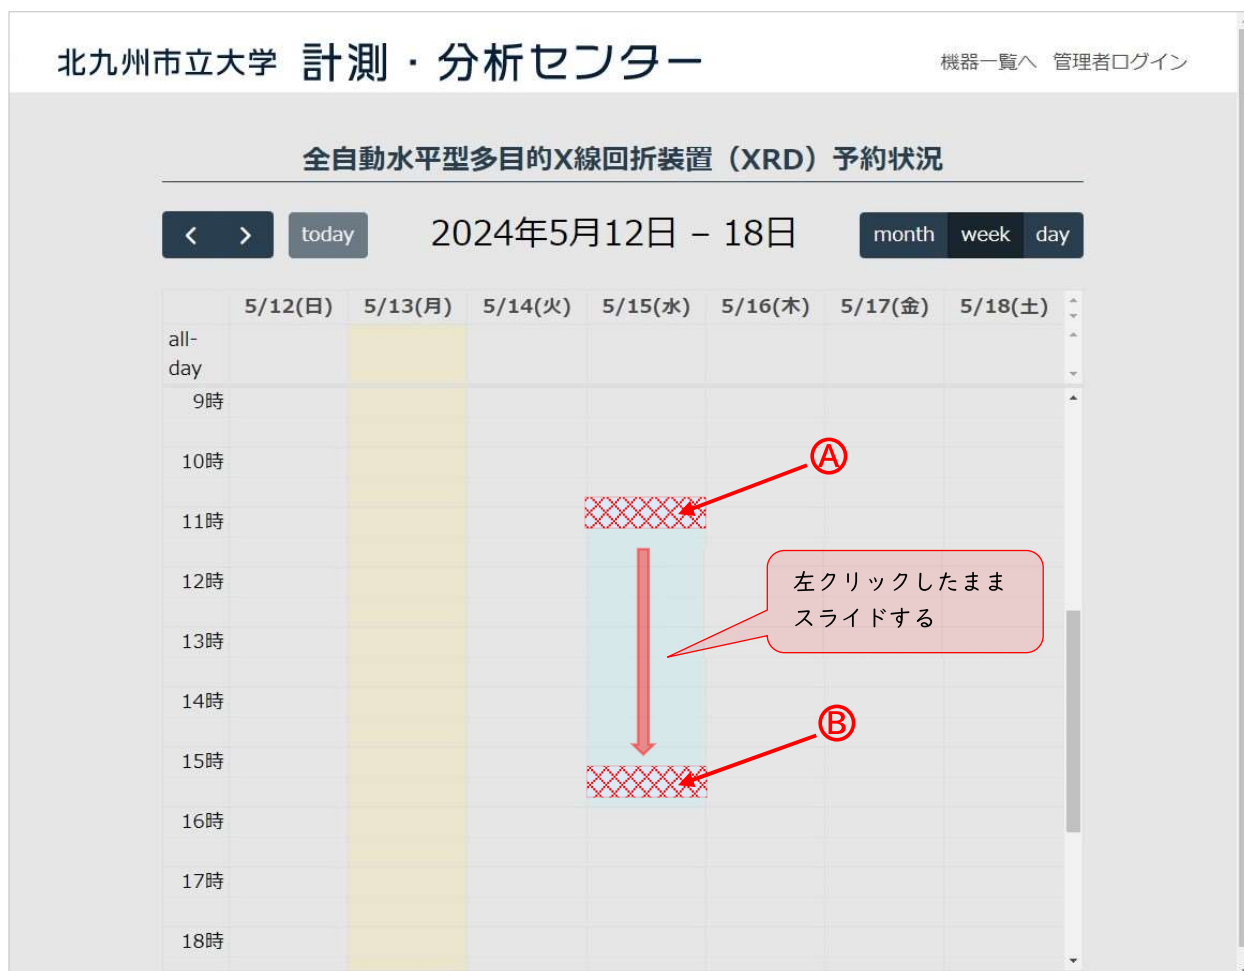


図3. 予約の取り方 (week のページ)

⑤ 予約情報入力画面（図 4）が表示されるので、下記の通りに入力する。

間違えてこの画面を開いた場合は、『×』（図 4 の A）をクリックするか『キャンセル』ボタン（図 4 の B）をクリックする。

入力が終わったら、『確認』ボタン（図 4 の C）を押す。

図 4. 予約情報入力画面

① 氏名：機器利用者の氏名

例)・山田太郎，山田ハナコ

全角で入力し、名前と名前の間は
空けない

・レオナルド ダ ヴィンチ

全角で入力し、名前と名前の間は
全角一文字空ける

・Leonardo da Vinci

半角で入力し、名前と名前の間は
半角一文字空ける

② 所属先：機器利用者の研究室の先生の氏名/所属先

例)・山田太郎

全角で入力し、名前と名前の間は
空けない

・〇〇〇株式会社

漢字・カタカナは全角，ローマ字は半角で
入力する

③ 電話番号：機器利用者の電話番号

④ メールアドレス：機器使用者のメールアドレス

⑤ 利用方法：変更しない

⑥ ご利用開始日：入力済（確認をお願いします）

違う場合は、日付選択ツールより
選択する。

⑦ ご利用開始時間：入力済（確認をお願いします）

違う場合は、プルダウン
メニューにより選択する。

⑧ ご利用終了日：入力済（確認をお願いします）

違う場合は、日付選択ツールより
選択する。

⑨ ご利用終了時間：入力済（確認をお願いします）

違う場合は、プルダウン
メニューにより選択する。

⑩ 削除・変更パスワード：適当な数字を入れる

⑥ 予約確認画面（図 5）が表示されるので、間違いがない場合は『OK』を押す。



図 5. 予約情報確認画面

⑦ 図 6 のようにカレンダーに予約が入るので、正しく入っているかどうか必ず確認する。

※当日が含まれない週で予約を入れた場合、手順⑥でOKを押した後は、画面は当日が含まれる週のカレンダーへ移動するので、図 6 の A をクリックしてカレンダーを移動させ、予約を入れた日時の日または週を表示させて、確認する。

※予約を間違えたり重複したりしてしまった場合は、6 ページの『予約が重なってしまった、間違っ予約してしまった場合』を参照してください。

※同じ装置の予約を続けて入れたいときは、手順③に戻って同じ手順で予約を入れる。

※別の装置の予約を入れたいときは、『機器一覧へ』（図 6 の B）をクリックする。手順②に戻るのと同じ手順で予約を入れる。



図 6. 計測・分析センター機器予約フォーム（予約完了画面）

～ 注意 ～

- ・ 予約の確定後の変更・削除はご自分ではできません。予約の変更・削除を行いたい場合は、できるだけ装置利用前日までに計測・分析センターへご連絡下さい。
- ・ この予約フォームでは依頼分析の予約はできません。担当の EA にご相談・ご依頼ください。

～ 予約が重なってしまった、間違っ予約してしまった場合 ～

予約が重なってしまった場合や、間違っ予約してしまった場合は、直ちに下記の手順で削除・変更を行ってください。

※ 間違いに気づいたらすぐに行ってください。予約が確定されると、ご自分での削除・変更が出来ません。その場合は、予約を入れた時間（予約が完了した時間）が遅い方の予約を、予告なくこちらで削除・変更いたしますので、ご了承ください。

- ① 自分の予約（今回の場合は、図 7 の A）をクリックする。

北九州市立大学 計測・分析センター

機器一覧へ 管理者ログイン

全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）予約状況

< > today 2024年5月26日 - 6月1日 month week day

	5/26(日)	5/27(月)	5/28(火)	5/29(水)	5/30(木)	5/31(金)	6/1(土)
all-day							
8時				8:30 - 12:00 山田太郎			
9時							
10時							
11時							
12時							
13時							
14時							
15時							
16時							
17時							

11:00 - 計測・分析センター

図 7. 計測・分析センター機器予約フォーム（予約が重なってしまった画面）

- ② 予約情報編集画面（図 8）が表示されるので、下記のように行う。
出来ない場合は、計測・分析センターEA に連絡する。

予約の変更：『ご利用開始日』、『ご利用開始時間』、『ご利用終了日』、『ご利用終了時間』の欄（図 8 の A）に予約が重ならないように入力し、『削除・更新パスワード』の欄（図 8 の B）に予約時に入力したパスワードを入れ、『更新』ボタン（図 8 の C）を押す。

予約の削除：『削除・更新パスワード』の欄（図 8 の B）に予約時に入力したパスワードを入れ、『削除』ボタン（図 8 の D）を押す。

The screenshot shows a web form titled "予約情報を入力してください" (Please enter reservation information). The form contains several input fields, each preceded by a green "必須" (Required) label. The fields are: 氏名 (Name) with example "例) 山田太郎", 所属名 (Affiliation) with "山田太郎", 電話番号 (Phone number) with example "例) 000-0000-0000", メールアドレス (Email address) with example "例) example@gmail.com", 利用方法 (Usage method) with a dropdown menu showing "通常利用", ご利用開始日 (Start date) with "2024/05/29" and a calendar icon, ご利用開始時間 (Start time) with a dropdown menu showing "08:30", ご利用終了日 (End date) with "2024/05/29" and a calendar icon, and ご利用終了時間 (End time) with a dropdown menu showing "12:00". A red box labeled 'A' encompasses the date and time fields. Below these is a field labeled "削除・変更パスワード" (Delete/Change password) with a placeholder "削除・変更パスワード". A red box labeled 'B' encompasses this password field. At the bottom are three large green buttons: "更新" (Update), "削除" (Delete), and "キャンセル" (Cancel). A red box labeled 'C' encompasses the "更新" button, and a red box labeled 'D' encompasses the "削除" button. Red arrows point from the labels A, B, C, and D to their respective areas on the form.

図 8. 予約情報編集

- ③ 図 9 のように、予約が削除・変更される（図 9 は予約が削除された場合）ので、確認する。

北九州市立大学 計測・分析センター

機器一覧へ 管理者ログイン

全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）予約状況

< > today 2024年5月26日 - 6月1日 month week day

	5/26(日)	5/27(月)	5/28(火)	5/29(水)	5/30(木)	5/31(金)	6/1(土)
all-day							
8時							
9時							
10時							
11時				11:00 - 17:00 計測・分析センター			
12時							
13時							
14時							
15時							
16時							
17時							

図 9. 計測・分析センター機器予約フォーム（削除・変更後）